










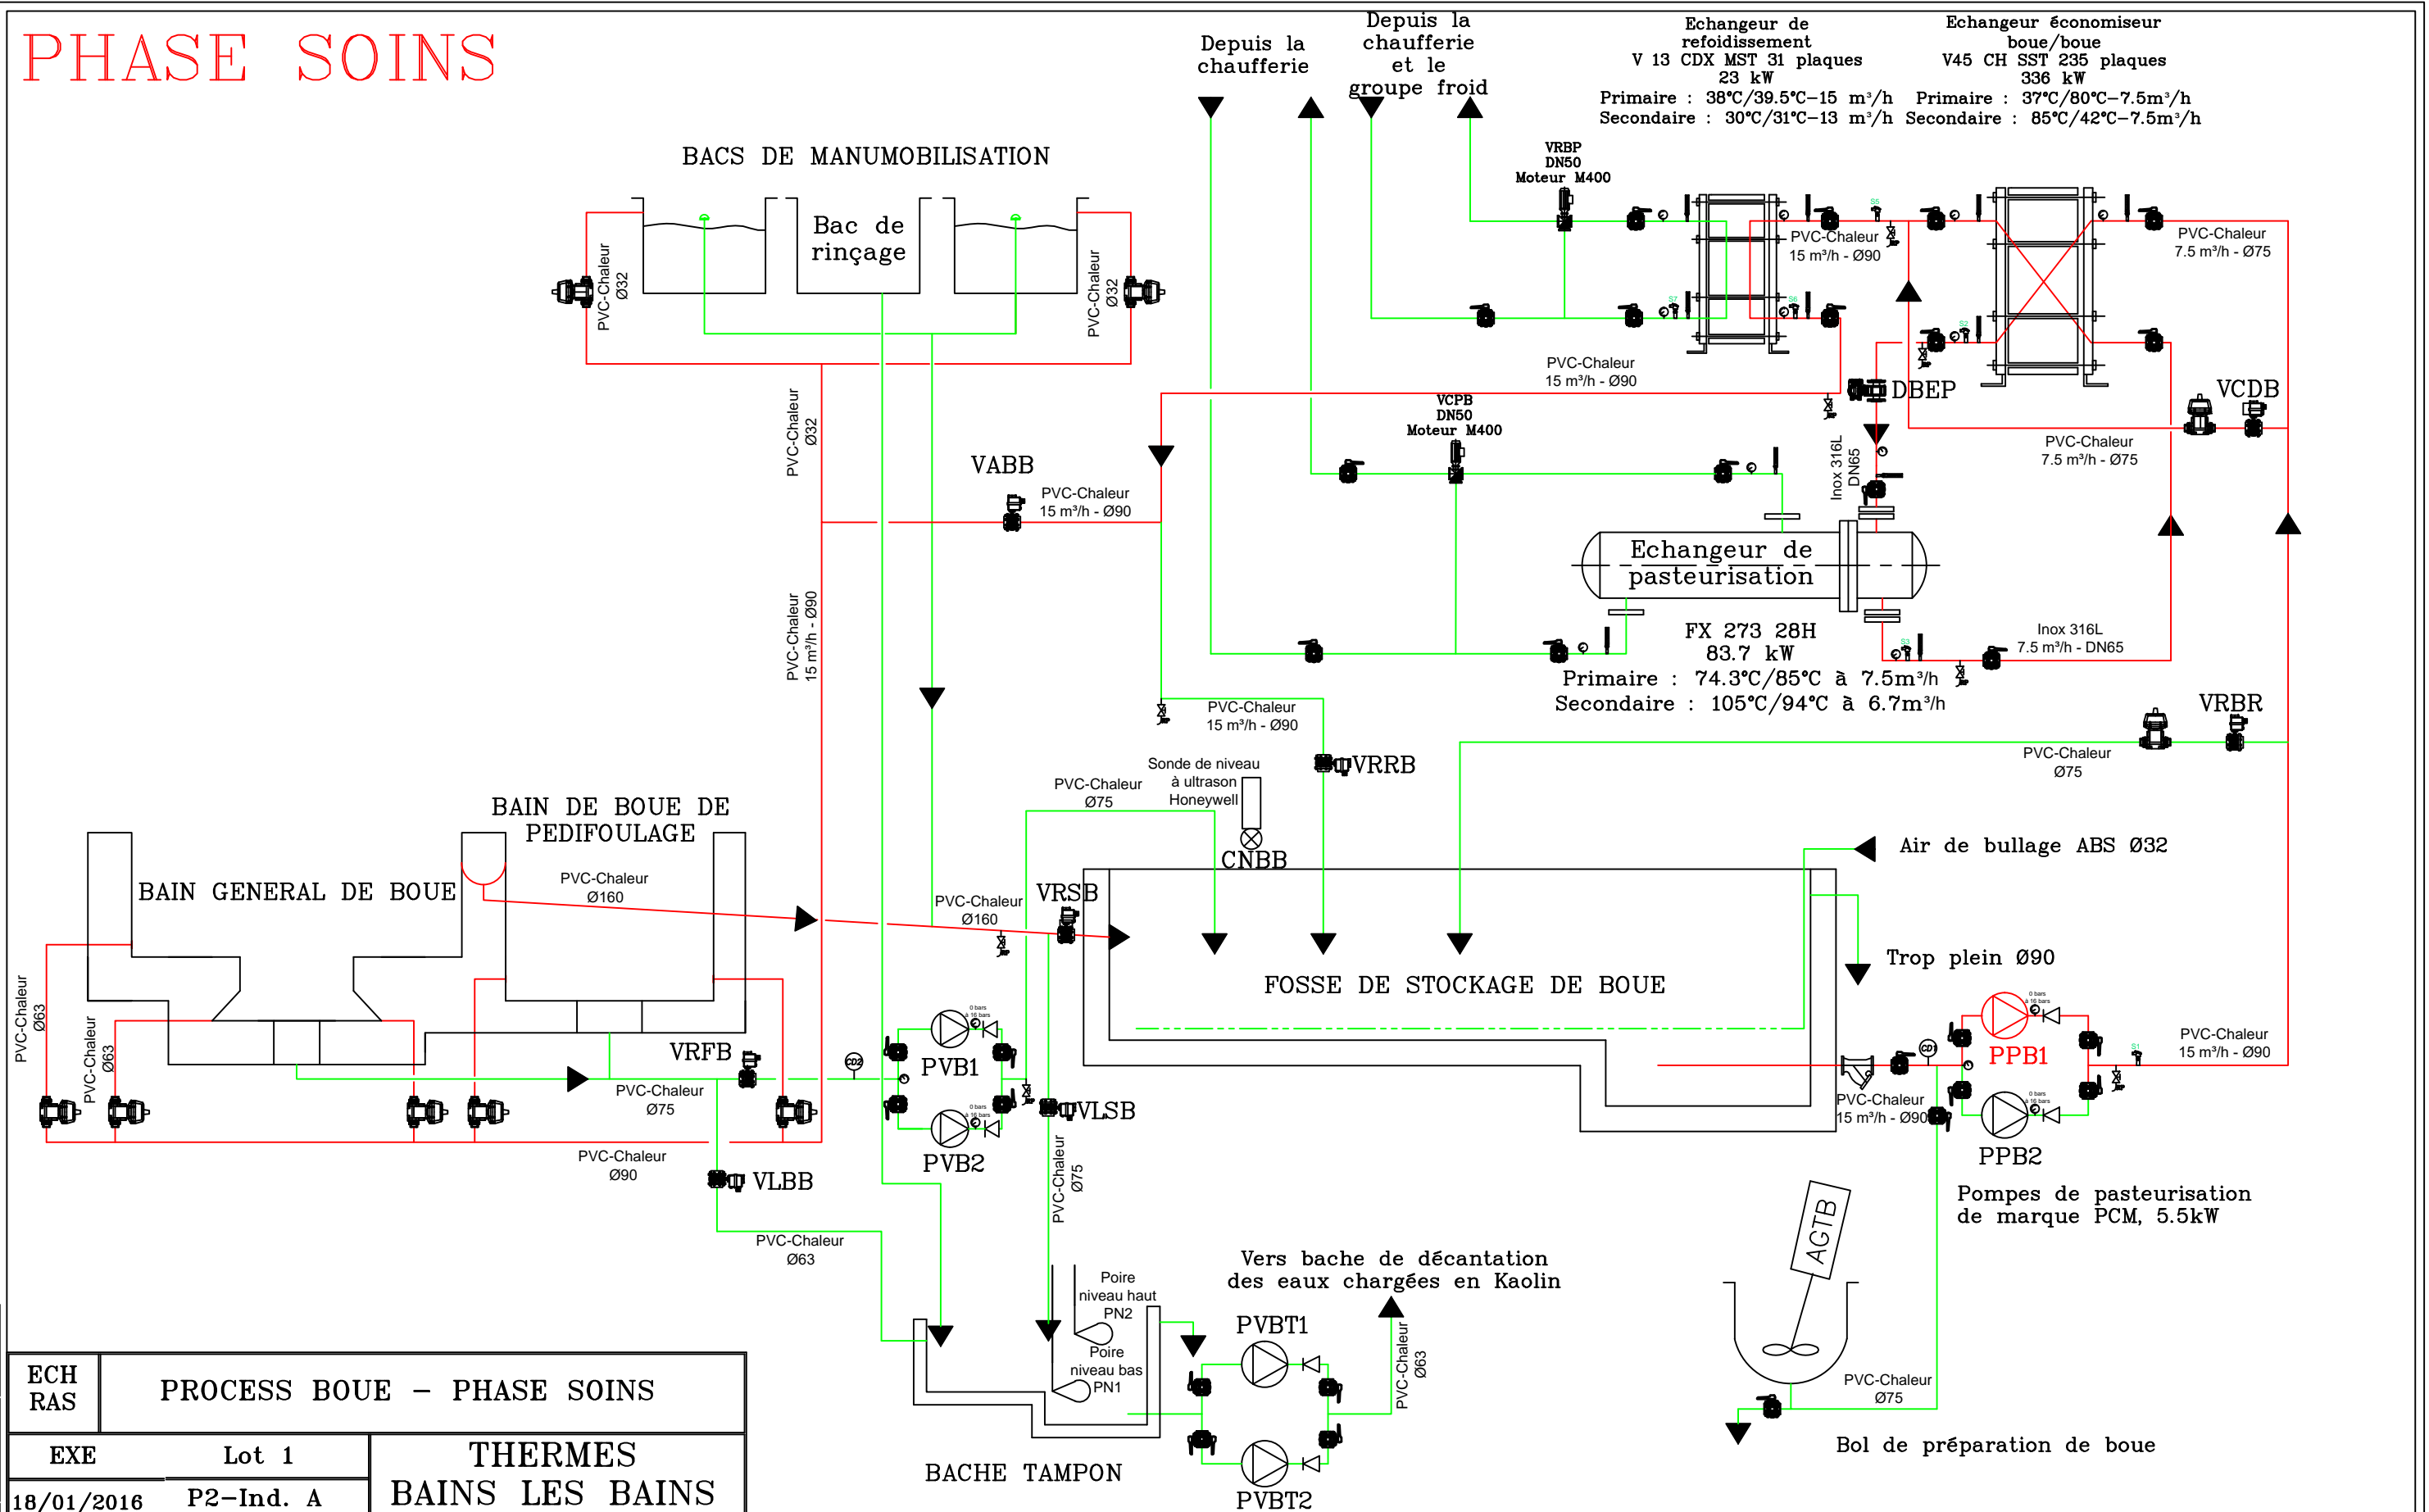









# PHASE SOINS



ECH RAS	PROCESS BOUE – PHASE SOINS	
EXE	Lot 1	THERMES
18/01/2016	P2-Ind. A	BAINS LES BAINS
 <p>LARGIER TECHNOLOGIE</p>		<p>LARGIER TECHNOLOGIE</p> <p>Génie climatique</p> <p>Tel: 04 75 37 42 29</p> <p>Fax: 04 75 37 68 22</p> <p>E-mail: <a href="mailto:contact@largier-technologie.fr">contact@largier-technologie.fr</a></p>

Légende:

- |   |                                  |   |  |   |                     |   |                      |   |                             |
|---|----------------------------------|---|--|---|---------------------|---|----------------------|---|-----------------------------|
|  | Contrôleur de débit électronique |  | Clapet anti-retour                         |  | Vanne motorisée     |  | Echangeur tubulaire  |  | Vanne trois voies motorisée |
|  | Filtre à tamis                   |  | Capteur de pression                        |  | Vanne à membrane    |  | Manomètre            |   |                             |
|  | Vanne d'isolement                |  | Robinet de prise d'échantillon<br>Servinox |  | Echangeur à plaques |  | Sonde de température |   |                             |
|  | Pompe de pasteurisation          |  | Vanne motorisée                            |  | Débitmètre          |  | Thermomètre          |   |                             |